

DETECCIÓN DE OXIDO DE GRAFENO EN SUSPENSIÓN ACUOSA (COMIRNATY™ (RD1))

ESTUDIO OBSERVACIONAL EN MICROSCOPIA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Informe provisional (I)

28 de Junio de 2021



Prof. Dr. Pablo Campra Madrid

Doctor en Ciencias Químicas y Licenciado en Ciencias Biológicas

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, ESPAÑA

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

1/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

AVISO IMPORTANTE

Seguidamente se presenta un estudio microscópico, observacional y meramente descriptivo de la muestra problema.

La identificación definitiva del material dominante en la muestra precisa de ulteriores fraccionamientos y análisis espectroscópicos específicos que permitan caracterizar la estructura del material.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por	Pablo Campa Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==	PÁGINA	2/24
				
wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==				

Antecedentes

- **D. Ricardo Delgado Martín** solicita PRESTACIÓN DE SERVICIOS de Investigación a la UAL denominada:

“DETECCIÓN DE GRAFENO EN MUESTRA DE SUSPENSIÓN ACUOSA”

- El 10/06/2021 se recibe por mensajería 1 vial, etiquetado con el texto siguiente:

- **“COMIRNATY™ .Sterile concentrate. COVID-19 mRNA. 6 doses after dilution. Discard date/time: PAA165994.LOT/EXP: EY3014 08/2021”**

- Procedencia y trazabilidad: se desconoce
- Estado de conservación: refrigerado
- Mantenimiento durante el estudio: refrigerado
- **Codificación de la muestra problema a analizar: RD1**

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

3/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Observaciones preliminares de la muestra problema RD1

Descripción:

- Vial sellado, con goma y tapa de aluminio intactas, de 2ml de capacidad, conteniendo una suspensión acuosa turbia de 0,45 ml.
- Se realiza extracción y cuantificación de RNA
- Se observa presencia de microbiología nanométrica no caracterizada, visible a 600X en microscopio óptico

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

4/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Procesamiento de la muestra

1. Dilución en suero fisiológico estéril al 0,9% (0,45 ml + 1,2 ml)
2. Fraccionamiento por polaridad: 1,2 ml hexano+120 ul de muestra RD1
3. Extracción de fase hidrofílica
4. Extracción y cuantificación de RNA en la muestra
5. Microscopía electrónica y ópticas de fase acuosa

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campa Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

5/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Análisis preliminar: extracción y cuantificación de Rna en la muestra

1. Extracción RNA: Kit <https://www.fishersci.es/shop/products/ambion-purelink-rna-mini-kit-7/10307963>
2. Cuantificación de absorbancia UV total en espectrofotómetro NanoDrop™ <https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-2000#/ND-2000>
3. Cuantificación específica de Rna por fluorescencia QUBIT2.0: <https://www.thermofisher.com/es/es/home/references/newsletters-and-journals/bioprobex-journal-of-cell-biology-applications/bioprobex-issues-2011/bioprobex-64-april-2011/the-qubit-2-0-fluorometer-april-2011.html>

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==


PÁGINA

6/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Espectro de absorción UV de la fase acuosa de la muestra **RD1** (Equipo Nano-drop)

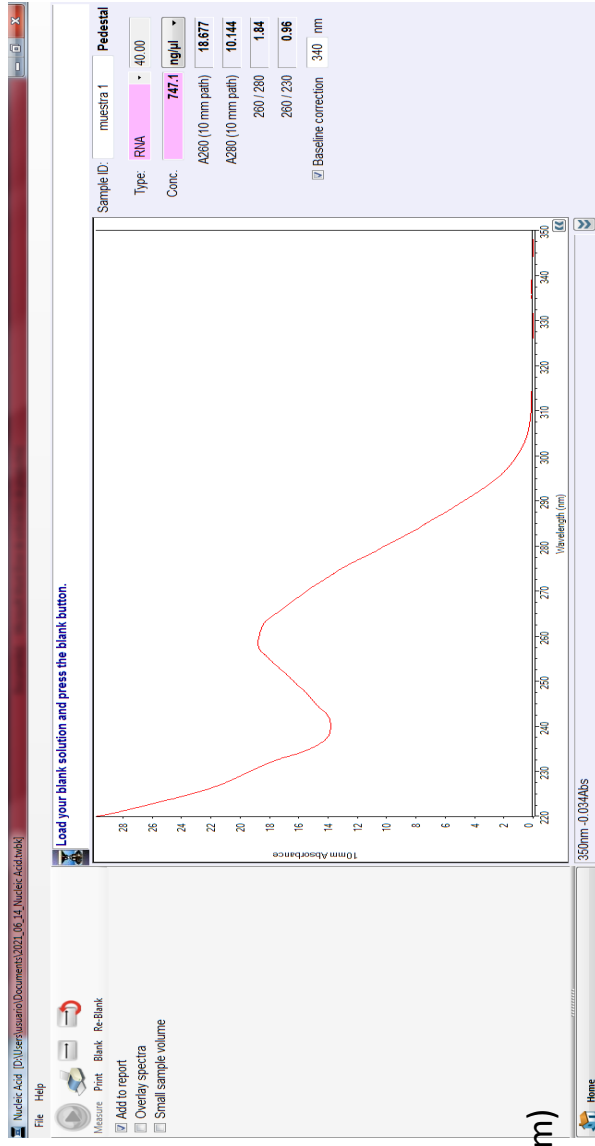

Máximo de absorción de la MUESTRA **RD1** (260-270 nm)

RNA. Presenta máximos habituales a 260 nm. Concentración total estimada por fluorometría QUBIT2.0 : **6 ng/ul**
El espectro revela presencia de elevada cantidad de sustancias o sustancia diferentes al Rna con máximo de absorción en la misma región, con un total estimado en **747 ng/ul** (estimación no calibrada)
El óxido de grafeno reducido (RGO) presenta máximos de absorción a 270 nm, **compatibles** con el espectro obtenido (*Thema et al, 2013. Journal of Chemistry ID 150536*)
El máximo de absorción obtenido NO PERMITE DESCARTAR la presencia de grafeno en la muestra. La cantidad mínima de RNA detectado por QUBIT2.0 sólo explica un porcentaje residual de la absorción total UV de la muestra.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==	PÁGINA	7/24
				
wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==				

OBJETIVO: Identificación microscópica de derivados de grafeno

METODOLOGIA:

1. Toma de imágenes en microscopia óptica y electrónica
2. Comparativa con imágenes de literatura y patrón de óxido de grafeno reducido

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

8/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISIÓN (TEM)

Microscopio electrónico JEM-2100Plus

Tensión: 200 kV

Resolución 0,14 nm

Aumento hasta x1.200.000

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

9/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISIÓN (TEM)

La microscopía electrónica (TEM) se utiliza habitualmente para obtener imágenes de nanomateriales de grafeno. Se ha convertido en un instrumento bastante estándar y fácil de usar que es capaz de obtener imágenes de láminas de grafeno en capas individuales.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

10/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN anterior

(de: Choucair et al, 2009. Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication. Nature Nanotechnology 4(1):30-3

- **Figura 2: “Imágenes TEM de las láminas de grafeno aglomeradas. La misma región de muestra se ve con diferentes aumentos y muestra claramente el grado de formación de la lámina y la tendencia de las láminas a fusionarse en regiones superpuestas. Es evidente una estructura inherente en forma de lámina que muestra una intrincada matriz de pliegues de largo alcance. Como las imágenes se toman en modo de transmisión, la opacidad relativa de las láminas individuales es el resultado de regiones interfaciales con superposición entre láminas individuales. Las láminas se extienden en dimensiones laterales sobre escalas de longitud micrométrica, que van desde 100 nm hasta más de 1.000 nm.”**

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campa Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA


11/24




wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

RESULTADOS: Comparativa de muestra problema (RD1) con una imagen TEM de literatura

MUESTRA RD1



Choucair et al 2009. Nature Nanotechnology 4(1):30-3 Fig 2






Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==	PÁGINA	12/24
				
wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==				

RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES TEM DE LA MUESTRA PROBLEMA RD1


Las imágenes TEM de la muestra RD1 en general **PRESENTAN UNA ELEVADA SEMEJANZA** con imágenes de **óxido de grafeno** de literatura obtenidas por la misma técnica TEM, con aumentos parecidos. Se puede observar una intrincada **matriz o malla de láminas flexibles translúcidas plegadas sobre sí mismas**, con mezcla de aglomeraciones multicapa más oscuras y de monocapas no plegadas de color más claro. Aparecen zonas lineares más oscuras debidas a la superposición local de láminas y a la disposición local de láminas individuales en paralelo al haz de electrones. Tras la malla aparece una elevada densidad de **formas claras redondeadas y elípticas sin identificar**, posiblemente correspondientes a orificios generados por forzamiento mecánico de la malla durante el tratamiento. Mostramos aquí 3 imágenes con aumento progresivo:



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por	Pablo Campa Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==	PÁGINA	13/24
				
wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==				

- **NOTA importante:** Para una IDENTIFICACIÓN definitiva del GRAFENO por TEM, es necesario complementar la observación con la caracterización estructural mediante obtención por EDS de un PATRÓN DE DIFRACCIÓN DE ELECTRONES característico (como la figura b mostrada abajo). El patrón correspondiente al grafito o el grafeno presenta una simetría hexagonal, y generalmente cuenta con varios hexágonos concéntricos. **No ha sido posible por el momento obtener este patrón por la escasez de muestra disponible para su procesamiento, y la disposición caótica y la densidad de los pliegues.**



Matéria (Rio J.) 23 (1) • 2018 • Characterization of graphene nanosheets obtained by a modified Hummer's method. Renata Hack et al.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campa Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

14/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Microscopio Óptico

Microscopio Biológico

CX43

- Condensador ajustado en posición intermedia con efecto 3D (entre campo Claro (BF) y campo oscuro (DF))

Objetivos PLAN Fluor de 10x, 20x (DIC) y 40x (DIC)
Ocular: 10x

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==


PÁGINA

15/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

16/24




wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

IDENTIFICACIÓN DE OXIDO DE GRAFENO Y SUS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES POR MICROSCOPIA OPTICA

Los materiales de grafeno esencialmente constan de una sola capa atómica. Esto hace que la observación del microscopio óptico basado en absorbancia sea difícil, aunque es posible adquirir imágenes ópticas de láminas de grafeno suspendidas bajo luz transmitida de campo claro (Fig. a). El grafeno oxidado (GO) tiene un color mucho más pálido que el reducido (rGO).

Sin embargo, bajo **iluminación reflectante**, la obtención de **imágenes ópticas de alto contraste de grafeno** e incluso láminas de GO se ha reportado en literatura. Modificando el ángulo de incidencia de la iluminación, mediante ajuste apropiado del condensador (campo claro y campo oscuro), esta ha sido la técnica empleada para aumentar el contraste en muestra RD1 del presente informe y obtener imágenes de la rugosidad en la superficie de las láminas con efecto 3D.



a) Campo claro. b-d) Microscopía de extinción de fluorescencia (FQM) Kim et al, 2010. Seeing graphene-based sheets, Materials Today, Volume 13, 2010, Pages 28-38,

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

17/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Imagen de literatura TEM de bajo aumento

“La figura muestra una imagen TEM de grafeno bicapa con bordes que tienden a enrollarse y doblarse ligeramente”

Qian, W., Hao, R., Hou, Y. et al. Solvothermal-assisted exfoliation process to produce graphene with high yield and high quality. Nano Res. 2, 706–712 (2009).



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

18/24




wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

**IMAGENES DE LITERATURA. MICROSCOPIA ELECTRONICA A BAJO AUMENTO
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM) (a) y (b) y TRANSMISION (TEM) (c) y (d)**

Effects of Graphene Nanosheets with Different Lateral Sizes as Conductive Additives on the Electrochemical Performance of LiNi_{0.5}Co_{0.2}Mn_{0.3}O₂ Cathode Materials for Li Ion Batteries. Figure 2. SEM images of different graphene sheet sizes: (a) GN-13 and (b) GN-28, and transmission electron microscopy (TEM) images of different graphene sheet sizes: (c) GN-13 and (d) GN-28.

Husu et al. Polymers 2020, 12(5), 1162



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

19/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Robust Magnetized Graphene Oxide Platform for In Situ Peptide Synthesis and FRET-Based Protease Detection

Kim et al, *Sensors* 2020, 20(18), 5275

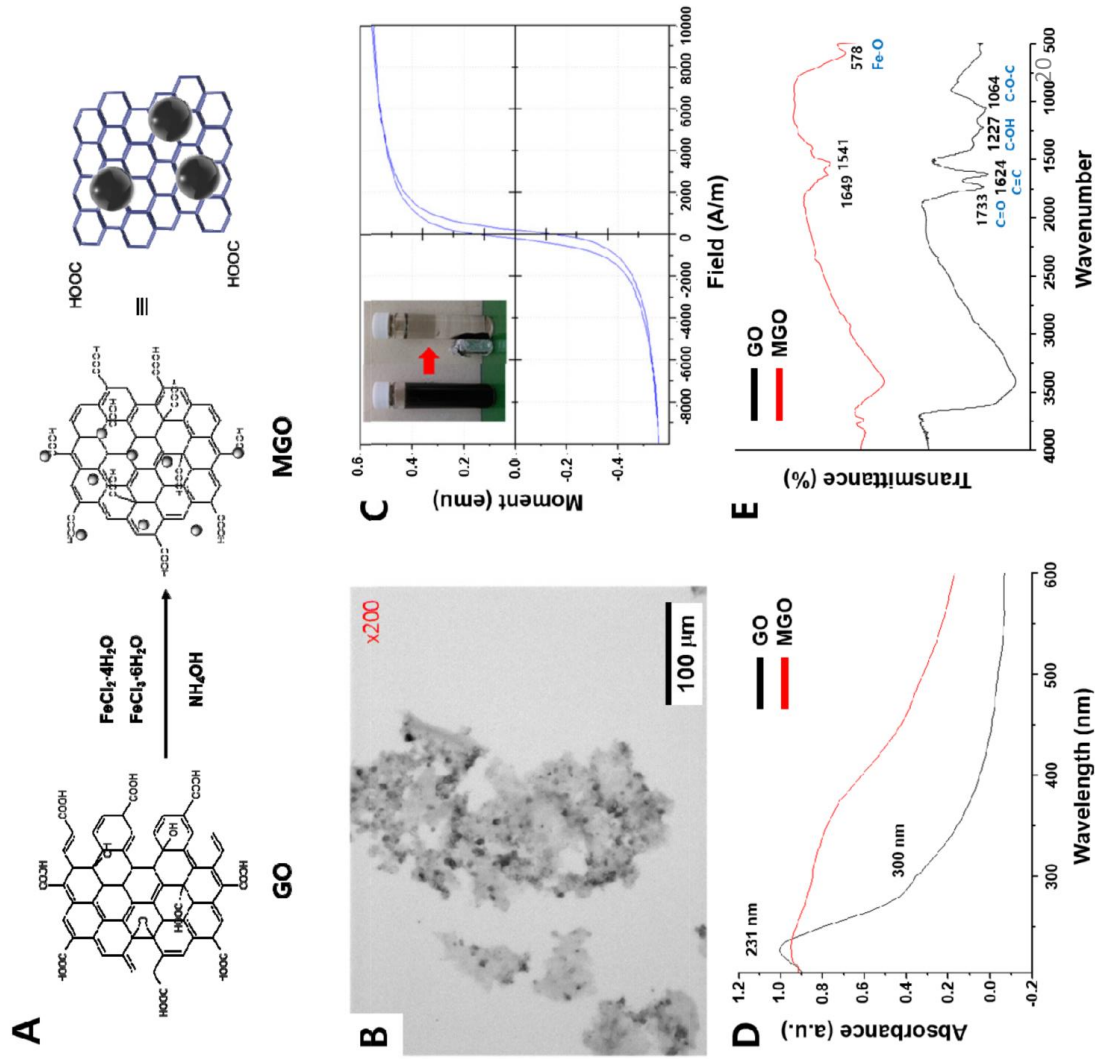


Figure 1. Preparation and characterization of graphene oxide (GO) and magnetized graphene oxide (MGO). (A) Schematic of MGO synthesis procedure. (B) Optical microscopy image of MGO. (C) Magnetic hysteresis loop of MGO. (D) UV/Vis absorption spectra of GO and MGO. (E) FT-IR spectra of GO and MGO.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/illL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/illL6TwQ==

PÁGINA

20/24




wHN2x8tkKPsiSy/illL6TwQ==

Comparativa de muestra RD1 al microscopio óptico con imágenes del patrón de OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO (rGO)

Las imágenes ópticas de las láminas presentes en la muestra RD1 revelan gran similitud con las láminas exfoliadas a partir de sonicación del patrón rGO. Ambas muestras presentan láminas translúcidas interiormente rugosas, con perfiles irregulares, plegadas sobre sí mismas y con tendencia a enrollarse en los bordes. Las formas y dimensiones de las láminas son muy variables, presentando en ambas muestras láminas en cintas o bandas plegadas sobre sí mismas (*ribbons*).

En el ANEXO adjunto se muestran imágenes alternas de MUESTRA PATRON DE rGO y MUESTRA PROBLEMA RD1



<https://cen.acs.org/articles/86/i14/Graphene-Ribbons.html>

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

21/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El estudio microscópico de la muestra aporta **sólidas evidencias de presencia probable de derivados de grafeno, si bien la microscopía no proporciona una prueba concluyente**. La identificación definitiva de grafeno, grafeno oxidado (GO) o grafeno oxidado reducido (rGO) en la muestra RD1 precisa de la **CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL** mediante el análisis de patrones espectrales específicos comparables a los publicados en literatura y a los obtenidos a partir de muestra patrón, obtenidos con técnicas espectroscópicas como XPS, EDS, RMN, FTIR o Raman, entre otras.
2. Los análisis de este informe corresponden a **UNA SOLA MUESTRA, limitada en volumen total disponible para procesar**. Es por tanto necesario realizar un muestreo significativo de viales similares para extraer conclusiones generalizables a muestras comparables, registrando origen, trazabilidad y control de calidad durante la conservación y transporte previas a los análisis.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campa Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

22/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

Exención de responsabilidad



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

Los resultados y conclusiones de este informe no implican posición institucional alguna de la Universidad de Almería

Ni el Investigador Principal ni La Universidad de Almería asumen responsabilidad alguna de los contenidos y opiniones de terceros sobre el presente informe a partir de su posible difusión en redes sociales o medios de comunicación, ni de las conclusiones que puedan extraerse del mismo que no hayan sido explicitadas en el texto.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

PÁGINA

23/24



wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==

VER ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA MUESTRA

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==	PÁGINA	24/24
				
wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==				

DETECCIÓN DE OXIDO DE GRAFENO EN SUSPENSIÓN ACUOSA (**COMIRNATY™ (RD1)**)

ESTUDIO OBSERVACIONAL EN MICROSCOPIA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
Informe provisional (I)
ANEXO FOTOGRAFÍAS

28 de Junio de 2021



Prof. Dr. Pablo Campra Madrid

Doctor en Ciencias Químicas y Licenciado en Ciencias Biológicas

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, ESPAÑA

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PÁGINA

1/30




jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

MICROSCOPIA ELECTRONICA

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	PÁGINA	2/30
			
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==			



**MUESTRA
RD1**

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es


jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PÁGINA

3/30



jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por
ID. FIRMA

Pablo Campra Madrid
afirma.ual.es

Pablo Campra Madrid


jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

Fecha
PÁGINA

28/06/2021
4/30




jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	5/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es


jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PÁGINA

6/30



jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	7/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

MICROSCOPIA OPTICA

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es

jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PÁGINA

8/30



jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 10X

Antes del tratamiento



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	9/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 10X

Tratamiento: Exfoliación de escamas de rGO mediante 30s sonicación suave con pulsos de 5s mediante sonda



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por

Pablo Campra Madrid

Fecha

28/06/2021

ID. FIRMA

afirma.ual.es


jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PÁGINA

10/30




jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	PÁGINA	11/30
			
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==			




MUESTRA
RD1
(campo
oscuro)

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	12/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				


PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 60x



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	13/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

MUESTRA
RD1 60X



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>


Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	14/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>


Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	15/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				



MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	PÁGINA	16/30
			
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==			




MUESTRA
RD1
(campo
oscuro)


Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>


Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	17/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	18/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				




MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	PÁGINA	19/30
			
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==			

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO




Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	PÁGINA	20/30



jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	21/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				


MUESTRA
RD1



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	22/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				


PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	23/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				


PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	24/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				


PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	25/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	26/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				




MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	27/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				

PATRON DE OXIDO DE GRAFENO REDUCIDO



Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>


Firmado Por	Pablo Campra Madrid	Fecha	28/06/2021	
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	28/30




[jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==](https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==)

MUESTRA
RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	29/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				



MUESTRA

RD1

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==>

Firmado Por	Pablo Campra Madrid		Fecha	28/06/2021
ID. FIRMA	afirma.ual.es	jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==	PÁGINA	30/30
				
jPnCXqeafqPbwofrC3oSXA==				